


Disabilitare il risparmio energetico per CamAps FX

Gestione delle impostazioni di alimentazione dei dispositivi Android e ottimizzazione delle applicazioni


Questa guida spiega come disabilitare il risparmio energetico e come abilitare il funzionamento in background dell'app CamAps FX ma può essere usata per tutte le applicazioni impegnate nella gestione del monitoraggio della glicemia: xDrip, Dexcom, Libre, Medtronic, Follow, per gli orologi: l'app Wear Os (orologi Android Wear), WatchDrip, Zepp, Mifit, Fitbit, ecc.


Poiché non abbiamo accesso a tutti i dispositivi con Android 6 e versioni successive, vorremmo sottolineare che queste impostazioni potrebbero essere visualizzate in modo diverso a seconda del telefono.


1. Impostazioni di Android. Purtroppo varia da telefono a telefono...

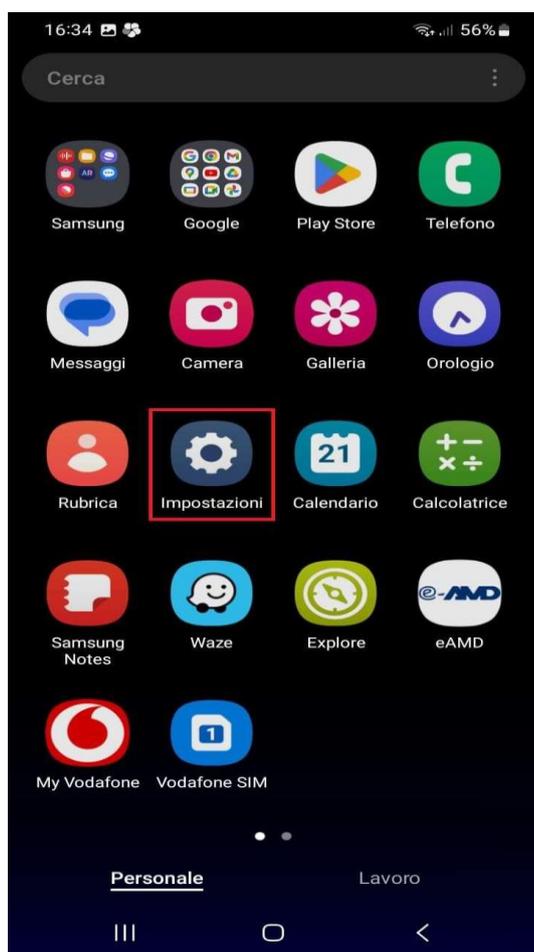


Seleziona l'app che ti interessa: xDrip, Dexcom, Libre, Medtronic, Dexcom Follow, applicazioni per gli orologi WatchDrip, Zepp, Mifit, Fitbit, ecc.

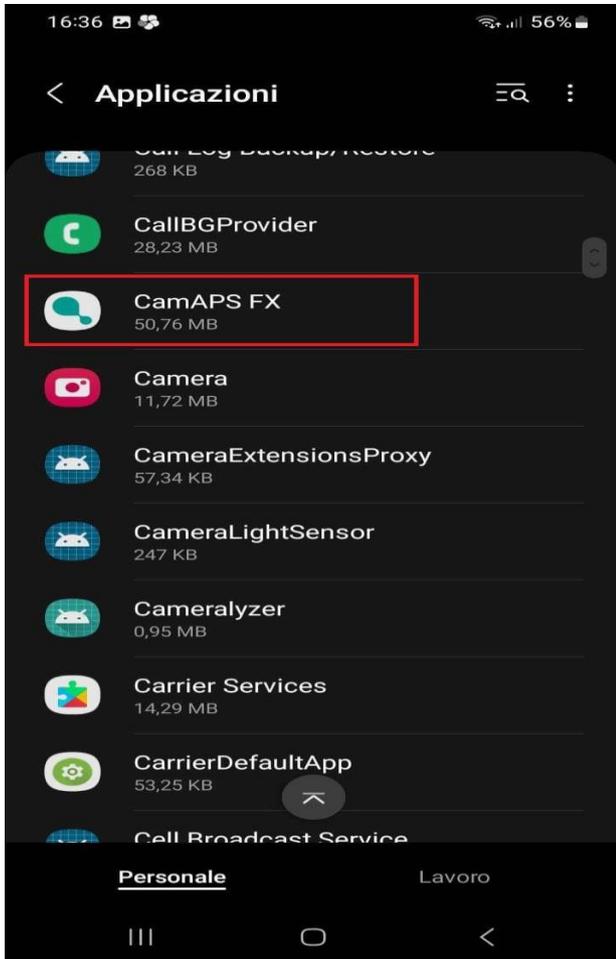


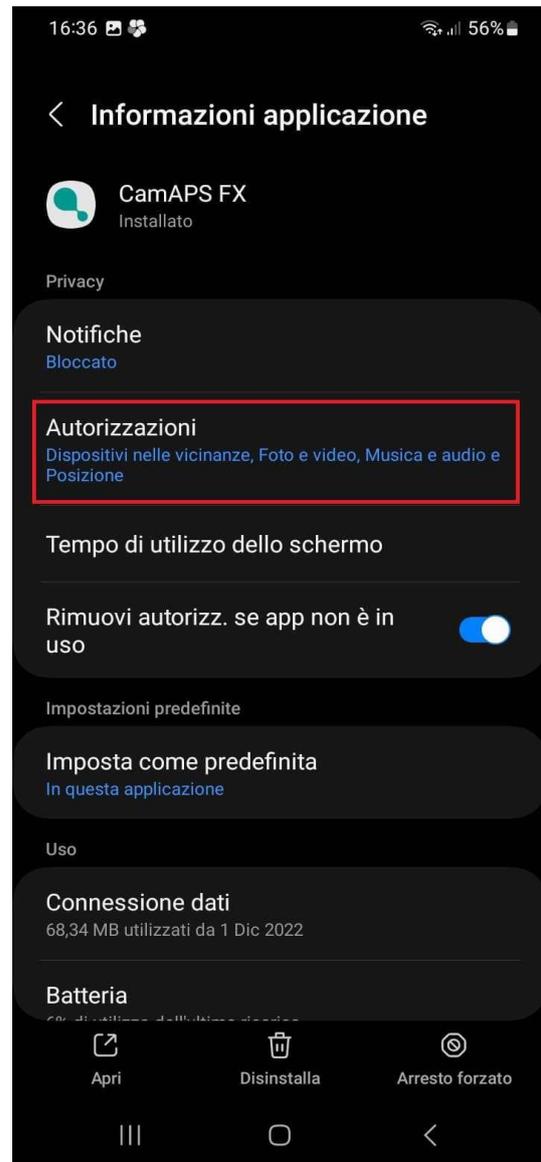

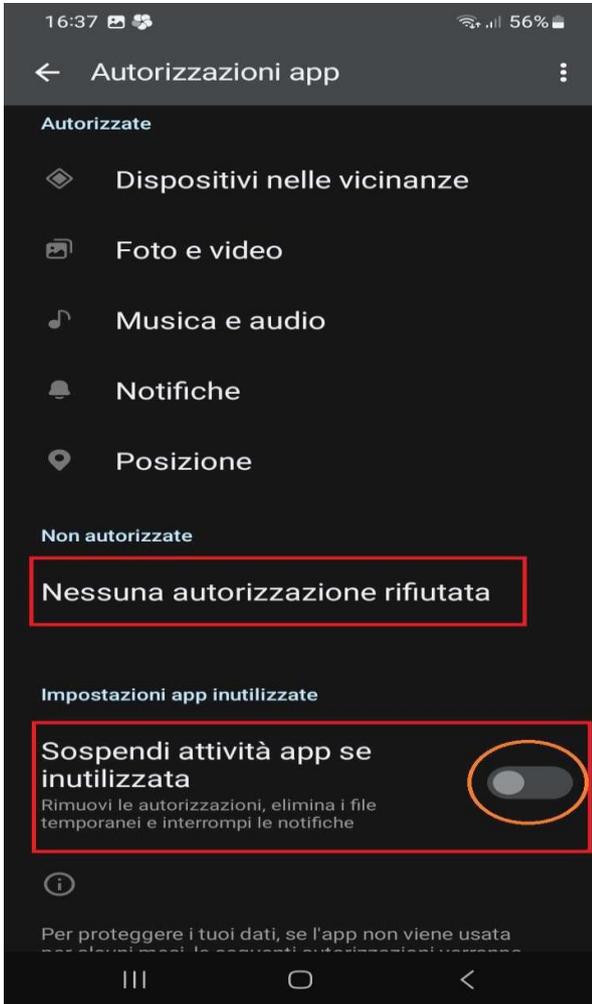


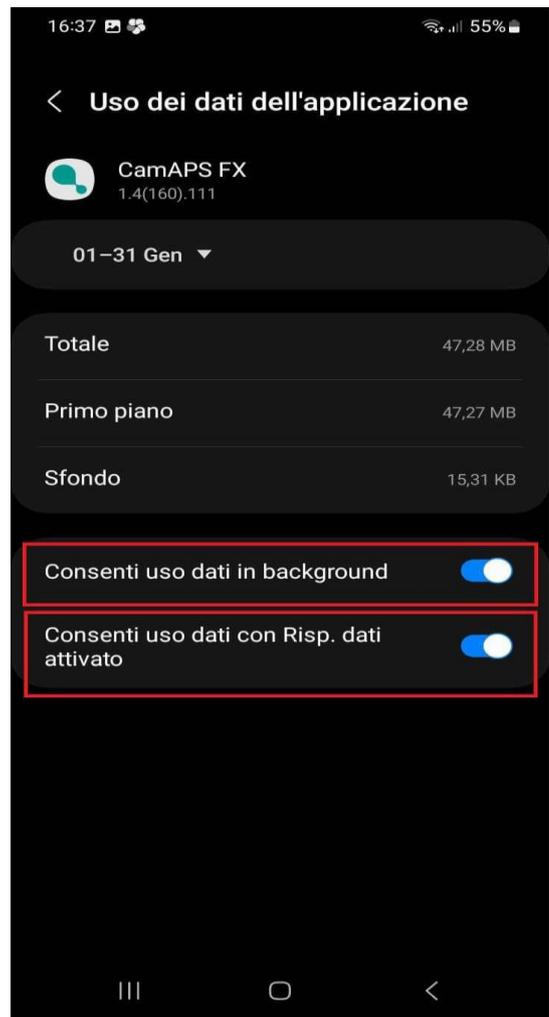


Non deve essere ottimizzato. Tutte le app che servono non devono essere ottimizzate.

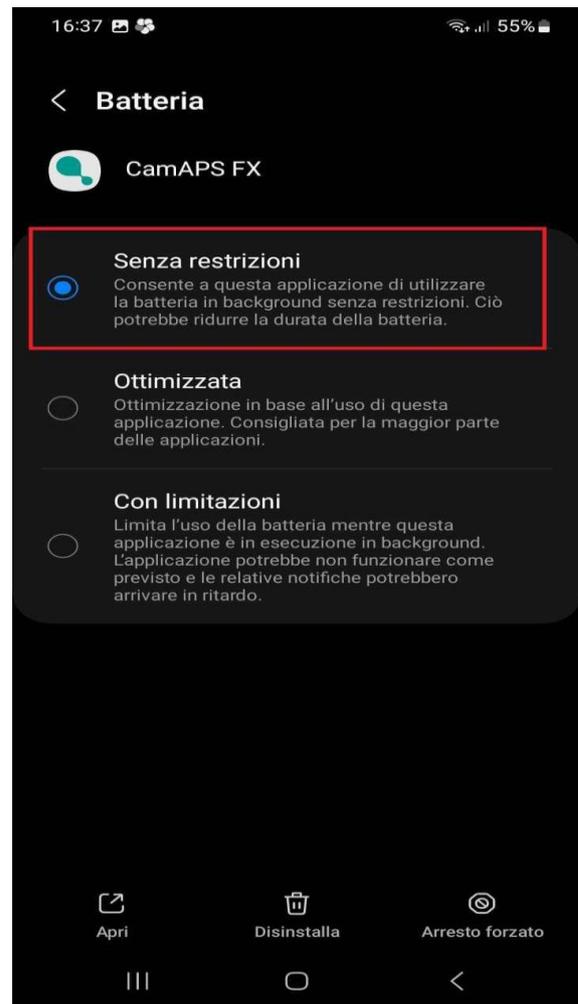

2. xDrip

Per xDrip+ devi verificare, cambiare e rimettere le impostazioni anche se già sono giuste


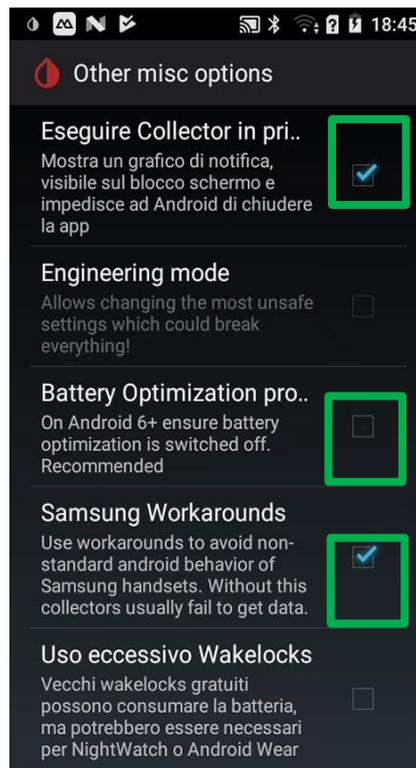
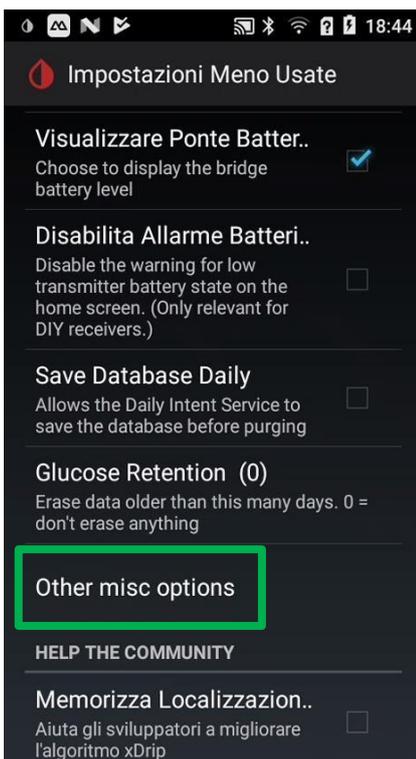


Togliere e rimettere
Deve essere abilitato




Attivare e togliere
Non deve essere
abilitato

Togliere e rimettere
Deve essere abilitato



Adesso serve controllare il Bluetooth.

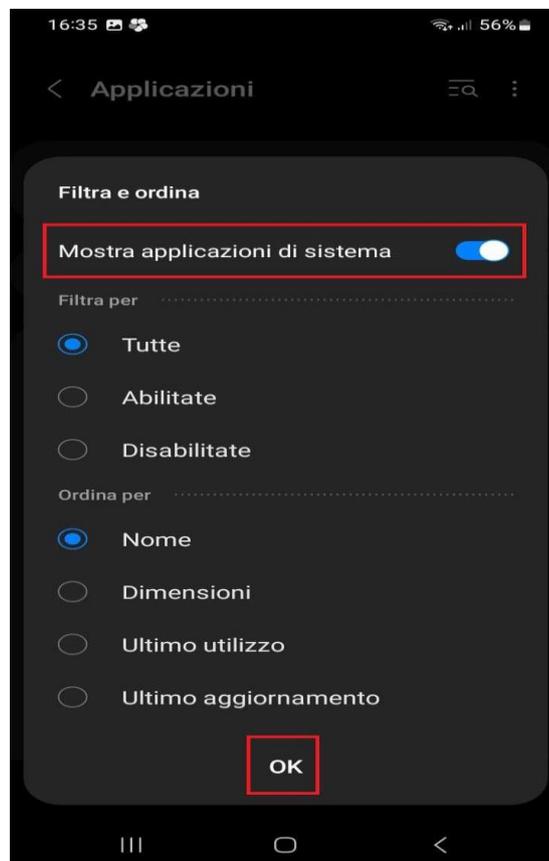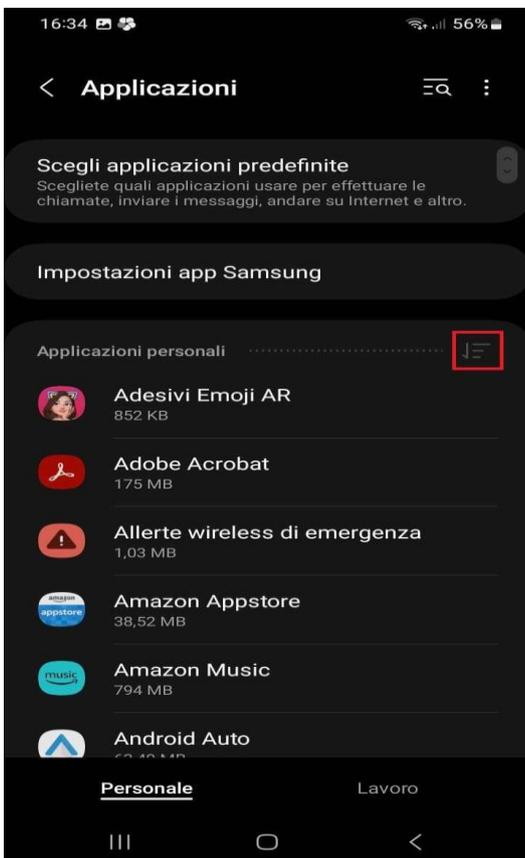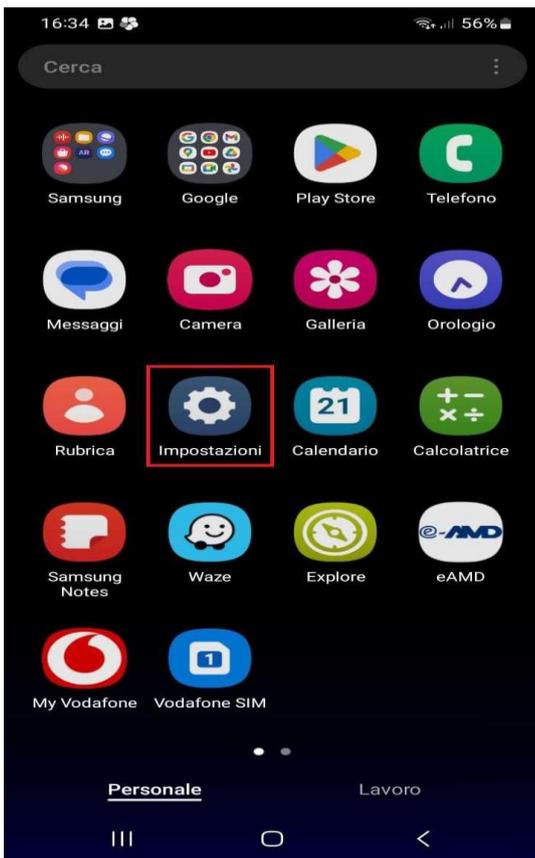

Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie

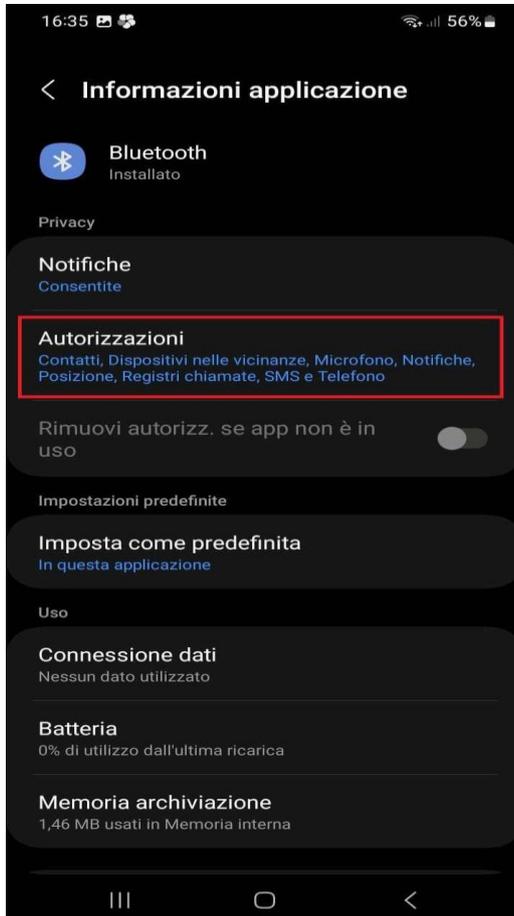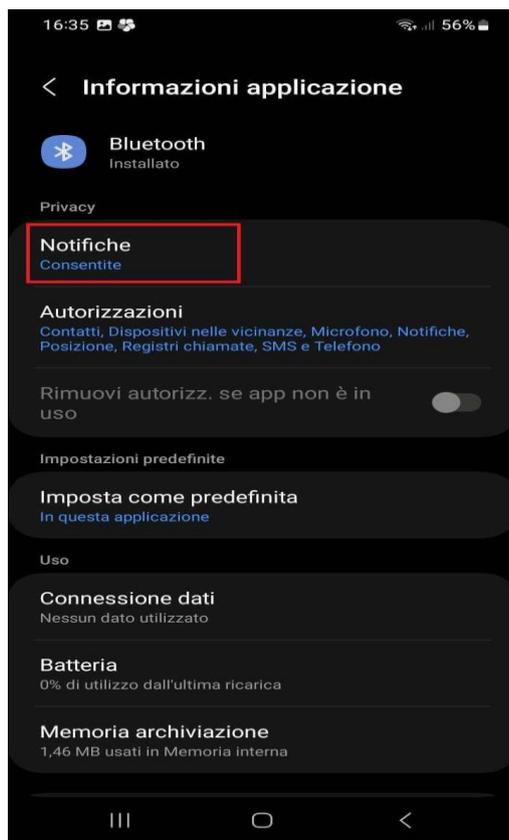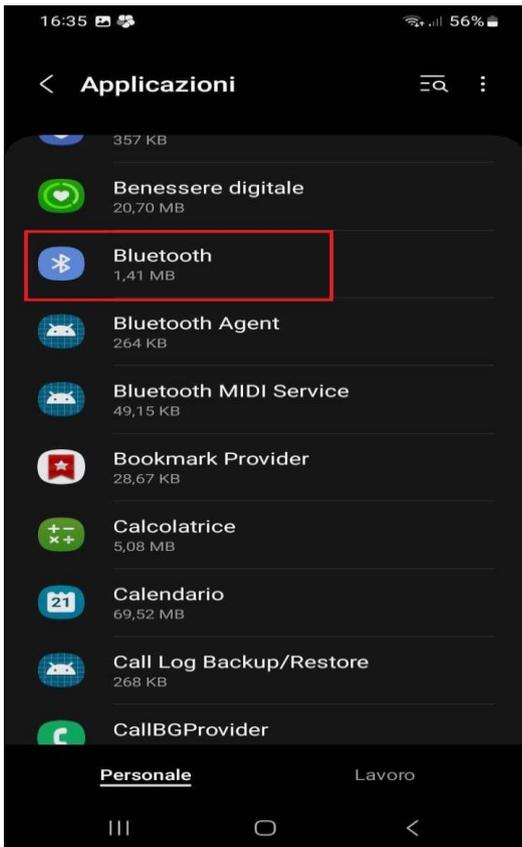

Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie

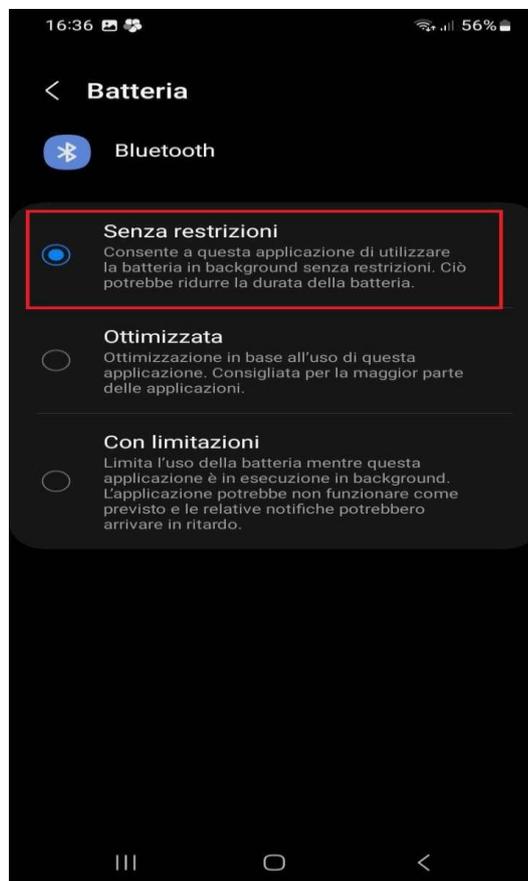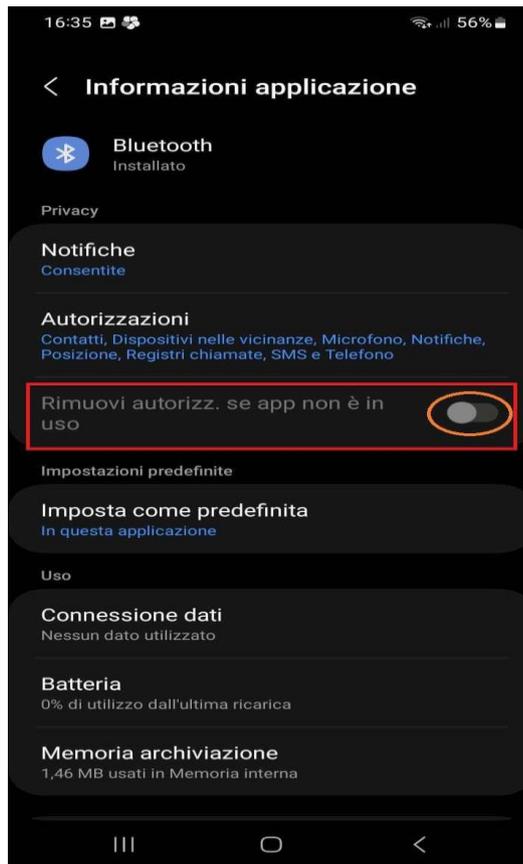

Contatti:



[Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie](#)